stryker

LIFEPAK® 20e

Défibrillateur/moniteur

Accessoires **certifiés**

Moniteur/défibrillateur **LIFEPAK 20e**

Accessoires certifiés de **Stryker**

Pour une sécurité optimale de votre personnel et de vos patients. Seuls les accessoires et consommables Stryker ont été testés de façon exhaustive avec les produits LIFEPAK. Choisissez une marque à laquelle vous faites confiance et la société qui la fabrique. Pour commander, veuillez contacter votre représentant Stryker.

Options d'alimentation

Câble d'alimentation CA
Alimente le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20e et recharge sa batterie interne.
11140-000015 (États-Unis)
11140-000019 (Europe)
11140-000023 (Afrique du Sud)
11140-000045 (Non fini)
11140-000017 (Australie)
11140-000022 (Royaume-Uni)
11140-000045 (Suisse)

Batterie interne rechargeable
Alimentation de secours en cas de défaillance de l'alimentation CA.
11141-000112 (Lithium-ion pour LIFEPAK 20e)

Batterie Lithium-ion pour Module CodeManagement®
Batterie rechargeable pour le Module CodeManagement ; à utiliser en tant qu'alimentation de secours en cas de défaillance de l'alimentation CA.
11141-000162 (Lithium-ion)

Accessoires de surveillance ECG

Câble ECG 5 brins
11110-000066

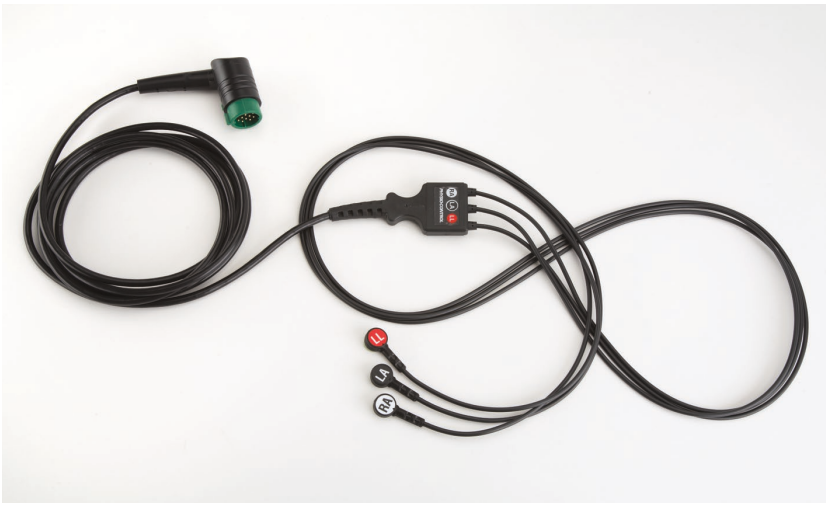

Câble ECG 3 brins
11110-000029

Électrodes pour ECG LIFE-PATCH®
Adulte, prégélifiées.
11100-000001 (boîte de 3)
11100-000002 (boîte de 4)

Électrodes pour ECG Cleartrace®
Adulte, bande transparente.
Disponible dans l'UE.
1700-003 (boîte de 3)

Papier pour imprimante ECG 50 mm x 22 mm
11240-000013 (3 rouleaux/boîte)

Module CodeManagement pour utilisation avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20e - Sans fil
Se branche au défibrillateur LIFEPAK 20e pour ajouter la connectivité sans fil.
11150-000018

Module CodeManagement pour utilisation avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20e - Sans fil et capnographie
Se branche au défibrillateur LIFEPAK 20e pour ajouter la connectivité sans fil et la surveillance par capnographie.
11150-000019

Accessoires de thérapie

Palettes dures et gel pour électrodes

Palettes adultes standard (dures) détachables

Les plaquettes des palettes adultes sont amovibles ; elles recouvrent les palettes pédiatriques.

11130-000037 (anglais)
11130-000038 (français)
11130-000045 (allemand/néerlandais)
11130-000046 (espagnol)
11130-000047 (italien)
11130-000048 (suédois)
11130-000049 (danois)
11130-000050 (finlandais)
11130-000051 (norvégien)
11130-000052 (polonais)
11130-000053 (brésilien)
11130-000054 (japonais)
11130-000055 (chinois)
11130-000057 (hongrois)
11130-000058 (tchèque)
11130-000059 (russe)
11130-000060 (coréen)
21330-001024 (plaquette de rechange)

Gel pour électrodes SIGNAGEL®

À utiliser avec les palettes dures. Électrolyte hautement conducteur, multi-usage, répondant aux normes d'un gel électrode salin idéal.
21300-005847 (240,97 g)

Poignée pour palette interne avec contrôle de la décharge

À utiliser avec les défibrillateurs/moniteurs LIFEPAK 15 ou 20e.
11131-000001 (1 paire)

Palettes internes (nécessitent des poignées de palettes internes et un câble adaptateur de palettes internes)

Taille : 2,5 cm
11131-000010 (1 paire, tige de 15,9 cm)

Taille : 3,80 cm
11131-000011 (1 paire, tige de 15,25 cm)
11131-000021 (1 paire, tige de 22,8 cm)
11131-000024 (1 paire, tige de 35,5 cm)

Taille : 5,1 cm
11131-000012 (1 paire, tige de 14,6 cm)
11131-000022 (1 paire, tige de 22,2 cm)<1}

Taille : 6,35 cm
11131-000013 (1 paire, tige de 14 cm)
11131-000019 (1 paire, tige de 21,6 cm)

Taille : 8,9 cm
11131-000014 (1 paire, tige de 12,7 cm)
11131-000023 (1 paire, tige de 20,3 cm)

Accessoires de thérapie

Électrodes EDGE System™ pour stimulation/défibrillation/ECG avec connecteur QUIK-COMBO®

Durée de stockage de 18 mois minimum, sauf indication spécifique

Électrodes EDGE System avec connecteur QUIK-COMBO
11996-000091 (Longueur de câble : 60 cm)

Électrodes EDGE System RTS (radiotransparentes) avec connecteur QUIK-COMBO
11996-000090 (Longueur de câble : 60 cm)

Électrodes pédiatriques EDGE System RTS (radiotransparentes) avec connecteur QUIK-COMBO
À utiliser uniquement avec les moniteurs/défibrillateurs manuels ; Durée de stockage de 12 mois à compter de la date d'expédition.
11996-000093 (Longueur de câble : 60 cm)

Électrodes EDGE System avec connecteur QUIK-COMBO et système de préconnexion REDI-PAK®
11996-000017 (Longueur de câble : 1,07 m)

Câble de thérapie QUIK-COMBO
11110-000004

Accessoires de surveillance de la concentration de CO_2 en fin d'expiration ($EtCO_2$)

Lignes de prélèvement pour patients intubés

Usage unique (un seul patient)

FilterLine® SET

Applications principales : bloc opératoire, EMS, ED, équipes d'intervention rapide, transport.

Adulte/pédiatrique

11996-000081 (boîte de 25, 200 cm)
11996-000164 (boîte de 25, 400 cm)

FilterLine H SET

Applications principales : soins critiques, environnements humides.

Adulte/pédiatrique

11996-000080 (boîte de 25, 200 cm)

Nourrisson/néonatal

11996-000001 (boîte de 25, 200 cm)

Lignes de prélèvement pour patients non intubés

Usage unique (un seul patient)

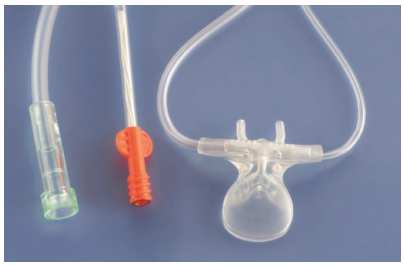

Smart CapnoLine® Plus

Applications principales : sédation en vue d'une intervention, interventions du tractus gastro-intestinal inférieur, MAC (anesthésie surveillée), AMU, urgences, équipes d'intervention rapide.

Adulte avec O_2

11996-000163 (boîte de 25, 200 cm)
11996-000167 (boîte de 100, 200 cm)
11996-000165 (boîte de 25, 400 cm)

Adulte sans O_2

11996-000162 (boîte de 25, 200 cm)
11996-000166 (boîte de 100, 200 cm)

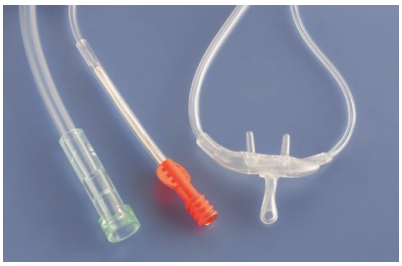

Smart CapnoLine

Applications principales : Sédation en vue d'une intervention, SMS, SD, équipes d'intervention rapide.

Pédiatrique avec O_2

11996-000128 (boîte de 25, 200 cm)

Pédiatrique sans O_2

11996-000120 (boîte de 25, 200 cm)

Accessoires de surveillance SpO_2

Câbles patients Masimo LNC® réutilisables

Câble patient LNCS
11171-000024 (1,2 m)
11171-000016 (3 m)
11171-000025 (4,25 m)
11171-000027 (rallonge de 1,2 m)

Capteurs Masimo compatibles LNC SpO_2 uniquement

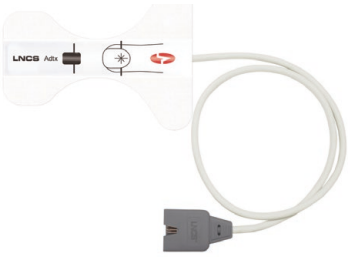

Capteur adhésif LNCS®
Usage unique (un seul patient).
(boîte de 20)
11171-000019 (Ad)
11171-000020 (Péd)
11171-000029 (Néonat/préma)
11171-000028 (Néonat/ad)
11171-000031 (Nourrisson)

Capteur LNCS® réutilisable
11171-000017 (Ad)
11171-000018 (Péd)

Capteur LNCS souple réutilisable
11171-000052 (Ad)

Capteurs à connexion directe Masimo réutilisables et câbles

Capteur à connexion directe souple réutilisable
11171-000051 (Ad)

Accessoires de surveillance SpO_2

Accessoires supplémentaires et câbles adaptateurs

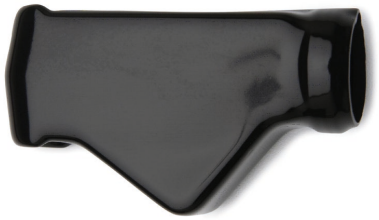

Protection lumière ambiante réutilisable
11171-000054 (boîte de 5)

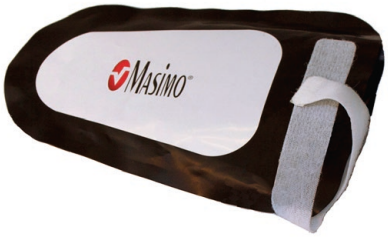

Protection lumière ambiante à usage unique
11171-000055 (boîte de 10)

Accessoires de surveillance SpO_2

Adaptateur Masimo – Nellcor™

Câble adaptateur MNC-1
Permet aux défibrillateurs/moniteurs LIFEPAK 20e spécialement configurés avec un dispositif de SpO_2 Masimo de se connecter aux capteurs Nellcor.
11996-000183 (3 m)
11996-000198 (1,2 m)

Adaptateur Masimo – capteurs de SpO_2 compatibles avec Nellcor

Capteur à clip DURASENSOR réutilisable
11996-000060 (Ad)

Capteur multisite DURA-Y réutilisable
11996-000106 (> 1 kg)

Capteur Oxiband réutilisable
50 capteurs adhésifs à usage unique inclus.
11996-000061 (Ad/Néonat)
11996-000062 (Péd/nourrisson)

Bande adhésive à usage unique (boîte de 100)
Non disponible au Canada.
11996-000048 (Ad/Néonat)
11996-000049 (Péd/nourrisson)

Capteurs adhésifs Oxisensor II
(boîte de 24)
11996-000113 (Ad, 45 cm)
11996-000114 (Ad, 90 cm)
11996-000116 (Péd, 45 cm)

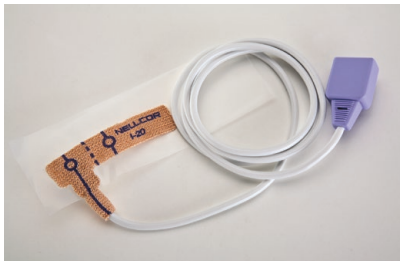

Capteurs adhésifs Oxisensor II
(boîte de 24)
11996-000115 (Nourrisson, 45 cm)
11996-000117 (Néonat/ad, 45 cm)

Sacoches de transport et accessoires de fixation

Sacoche de transport de base/ rangement des accessoires
Avec poches droite et gauche pour accessoires supplémentaires.
11260-000018

Sacoche de transport du défibrillateur LIFEPAK 20e avec Module
Avec poches droite et gauche pour le rangement d'accessoires supplémentaires. Pour utilisation avec l'appareil LIFEPAK 20e avec Module CodeManagement.
11260-000045

Poche supérieure
Pour rangement supplémentaire : insérer à la place des palettes standard.
11260-000043

Bandoulière pour sacoche de transport de base
Supports et pièces de montage inclus.
11260-000041

Station d'accueil
Se fixe au chariot d'urgences et verrouille le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20e fermement en place.
21330-000996

Poche pour accessoires sur le flanc droit
Se fixe au défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20e et permet de ranger des accessoires tels que le câble de thérapie QUIK-COMBO, les électrodes et le gel pour électrodes SIGNAGEL.
11260-000016

Outils de formation et testeurs

Simulateur d'état du patient (QUIK-COMBO)
Se connecte directement à votre défibrillateur LIFEPAK afin de simuler une cardioversion et un rythme cardiaque en toute sécurité. Simule des fibrillations, tachycardies et bradycardies, ainsi que des anomalies du segment ST et de l'onde T.
11996-000311 (12 dérivations)
11996-000310 (3 dérivations)

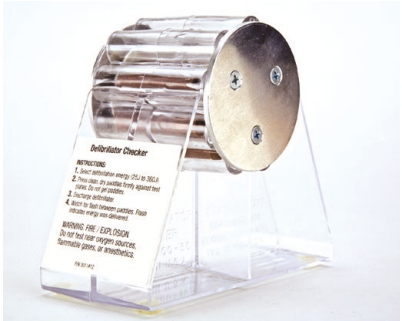

Testeur de défibrillation
Teste l'énergie délivrée à l'aide des palettes dures standard. Un néon lumineux indique que l'énergie a été délivrée.
11998-000060

Connecteur de test QUIK-COMBO
Le connecteur de test se branche sur le câble de thérapie QUIK-COMBO pour vérifier son bon état.
11113-000002

Documentation, accessoires de communication et accessoires d'autres marques

Mode d'emploi :

26500-003504 (portugais du Brésil)
26500-003529 (anglais international)
26500-003530 (allemand)
26500-003531 (italien)
26500-003532 (français)
26500-003533 (néerlandais)
26500-003534 (espagnol)
26500-003535 (portugais européen)
26500-003536 (suédois)
26500-003537 (danois)
26500-003538 (finlandais)
26500-003539 (norvégien)
26500-003540 (polonais)
26500-003541 (hongrois)
26500-003542 (tchèque)
26500-003749 (turc)

DVD de mise en service

26500-003545 (DVD en anglais)

Manuel d'entretien

26500-003543 (CD en anglais - LIFEPAK 20e avec Module CodeManagement)

Accessoires de communication

Câble pour port série

Pour la connexion du défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20e à un ordinateur personnel.
11230-000018 (1,83 m)

Câble de configuration en transport

Pour la connexion d'un LIFEPAK 20e au défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20e.
11230-000019 (1,83 m)

LIFEPAK 20e
IMPRIMER
RESUME D'ECG
EVENEMENT
Secteur
Technicien
Navigation rapide
ALARMES
OPTIONS
PAUSE
MARCHE
SELECT. ENERGIE
CHARGER
MODE DSA
ANALYSE
DRIV.
TAIL.
SYNC
STIMUL. CARDI
FREQ.
COURANT
ECG
SpO2
CO2
ATTENTION DANGER
WARNING
9

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre représentant Stryker ou visitez notre site à l'adresse strykeremergencycare.com

Emergency Care (Soins d'urgence)

Stryker ou ses filiales sont titulaires de, utilisent ou ont déposé une demande des marques commerciales ou marques de service suivantes : CodeManagement, EDGE System, LIFEPAK, REDI-PAK, QUIK-COMBO, Stryker, Masimo, le logo Radical, Rainbow et SET sont des marques déposées de Masimo Corporation. Toutes les autres marques commerciales sont des marques commerciales de leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Le fait que le nom ou logo d'un produit, d'une fonctionnalité ou d'un service ne figure pas dans cette liste ne constitue pas, de la part de Stryker, une renonciation à ses droits de marques commerciales ou à d'autres droits de protection de la propriété intellectuelle portant sur ce nom ou logo.

01/2020
GDR 3301814_D
Copyright © 2020 Stryker

Distributed by:

Stryker
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Toll free 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distributed by:

Stryker France SAS
ZAC avenue Satolas
Green
69330 Pusignan - France

+33 (0) 472 453 600