IntelliVue MX40
Patient Cable Adapter, Trunk, and Extender Cables

Instructions for Use

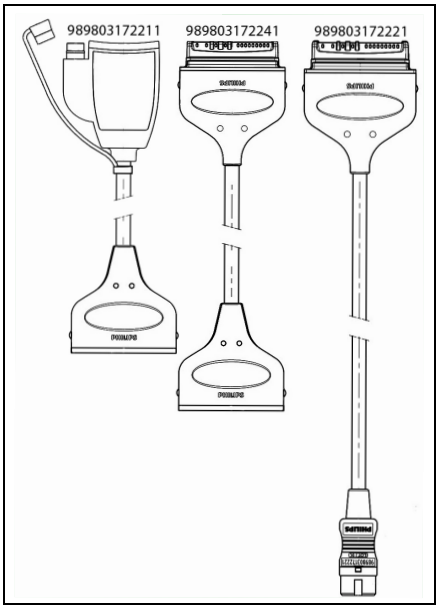

989803172211
Adapter Cable
Bedside/Tele
ECG + SpO_2

989803172241
Telemetry
Extender Cable

989803172221
ECG Trunk Cable
AAMI/IEC

PHILIPS

Extender, Adapter, and Trunk Cables are multi-patient use products. For cleaning, disinfection, and product compatibility, reference the *IntelliVue MX40 Instructions for Use*.

Les câbles adaptateurs et d'extension, ainsi que les câbles patient, sont des produits destinés à être utilisés sur plusieurs patients. Pour plus d'informations sur le nettoyage, la désinfection et la compatibilité de ces produits, consultez le *Manuel d'utilisation du moniteur IntelliVue MX40*.

Verlängerungs-, Adapter- und EKG-Stammkabel sind wiederverwendbar. Hinweise zu Reinigung, Desinfektion und Produktkompatibilität sieheh in der *Gebrauchsanweisung des IntelliVue MX40*.

Verlengstuk, adapter en aansluitkabels zijn geschikt voor gebruik bij meerdere patiënten. Raadpleeg de *gebruiksaanwijzing van de IntelliVue MX40* voor reiniging, desinfectie en productcompatibiliteit.

La extensión, el adaptador y los cables de paciente son productos que pueden utilizarse con varios pacientes. Si desea información sobre la limpieza, desinfección y compatibilidad del producto, consulte las *Instrucciones de uso de IntelliVue MX40*.

Extensões, adaptadores e cabos principais são produtos destinados ao uso em diferentes pacientes. Consulte as *Instruções de Uso do IntelliVue MX40* para obter diretrizes de limpeza, desinfecção e compatibilidade do produto.

Il cavo di prolunga, il cavo adattatore e il cavo paziente sono riutilizzabili su più pazienti. Per la pulizia, la disinfezione e le specifiche di compatibilità, consultare le *Istruzioni d'uso di IntelliVue MX40*.

Förlängare, adapter- og apparatkabler er produkter som kan brukes til flere pasienter. Se *bruksanvisningen for IntelliVue MX40* hvis du vil ha informasjon om rengjøring, desinfisering og produktkompatibilitet.

Förlängare, adapter och mellankablar är produkter som kan användas på flera patienter. Information om rengöring, desinfektion och produktkompatibilitet finns i *bruksanvisningen till IntelliVue MX40*.

Forlænger, adapter og trunk-kabler er til brug med flere patienter. For oplysninger om rengøring, desinfektion og produktkompatibilitet henvises til *Brugerhåndbogen til IntelliVue MX40*.

A bővítő, az adapter és a törzskábelek több beteget is használhatók. A tisztításhoz, a fertőtlenítéshez és a termékek kompatibilitásával kapcsolatban tekintse meg az *IntelliVue MX40 használati utmutatóját*.

Kable rozszerzeń, łączące i zbiorcze są przeznaczone do stosowania u wielu pacjentów. Informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i zgodności produktów można znaleźć w *Instrukcji obsługi monitora pacjenta IntelliVue MX40*.

Produlžovací, adaptérové a kmenové kabely jsou výrobky, které lze použít pro více pacientů. Informace o čistění, dezinfekci a kompatibilitě výrobků najdete v *Návodu k obsluze IntelliVue MX40*.

Rozširovacie, prechodové a kmeňové káble sú produkty určené na použitie pri viacerých pacientoch. Informácie o čistení, dezinfekcii a kompatibilite produktov nájdete v *Návode na obsluhu zariadenia IntelliVue MX40*.

Podaljšek, adapter in oklopljeni kabli so primerni za uporabo z več pacienti. Za čiščenje, razkuževanje in združljivost izdelkov *glejte navodila za uporabo sistema IntelliVue MX40*.

Cablurile prelungitoare, adaptoare și principale sunt produse cu utilizare la mai multi pacienți. Pentru informații despre curățare, dezinfectare și compatibilitatea produsului, consultați *Instrucțiunile de utilizare IntelliVue MX40*.

Удлинительные кабели, адаптерные и пациентные кабели са продукти за употреба с различни пациенти. Относно почистването, дезинфекцията и съвместимостта на продуктите вижте *Указанията за употреба на IntelliVue MX40*.

Pikendus-, adapter- ja peakaabli on tooted, mis on mõeldud kasutamiseks mitmel patsiendil. Puhastamise, desinfitseerimise ja tooteega ühilduvuse kohta leiate teavet *IntelliVue MX40 kasutusjuhendist*.

Pagarinėjimo, adaptero ir pagrindinės kabelių yra gaminiai, skirti naudoti keliems pacientams. Norėdami užtikti valymo, dezinfekavimo ir gaminio reikalavimus, skaitykite *„IntelliVue MX40 naudojimo instrukciją“*.

Pelkės, adapteris ir magistralinės laidai yra gaminiai, skirti naudoti keliems pacientams. Norėdami užtikti valymo, dezinfekavimo ir gaminio reikalavimus, skaitykite *„IntelliVue MX40 naudojimo instrukciją“*.

Pagarinātājs, adapteris un magistrālie kabeļi ir vairākiem pacientiem lietojami. Informāciju par tīrīšanu, dezinfekciju un produktu saderību skatiet *IntelliVue MX40 lietošanas pamācībā*.

Удлинительные кабели, кабели-адаптеры и магистральные кабели предназначены для многократного использования. Сведения о чистке, дезинфекции и совместимости изделий см. в *руководстве по эксплуатации монитора IntelliVue MX40*.

Ο εξοπλισμός επεκτάσεως, ο προσαρμογέας και τα βασικά καλώδια είναι προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε πολλούς ασθενείς. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη συμβατότητα με άλλα προϊόντα, ανατρέξτε στο *έγγραφο IntelliVue MX40 Οδηγίες χρήσης*.

Uzatma Kabloları, Adaptör ve Ana Kabloları birden fazla hastada kullanılabilen ürünlerdir. Temizleme, dezenfeksiyon ve ürün uyumluluğu hakkında bilgiler için *IntelliVue MX40 Kullanım Talimatları*na bakın.

Ужаатхийн, адаптер және магистральді кабельдер бірнеше емделушіге арналған. Тазалау, дезинфекция және өнім үйлесімділігі туралы ақпаратты *IntelliVue MX40 пайдалану нұсқаулығынан* қараңыз.

延長接続ケーブル、接続ケーブル、および患者ケーブルは、複数の患者に使用できる主ケーブル製品です。清掃、消毒、および製品の互換性については、『IntelliVue MX40 ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

延長線、轉接器和主導線爲可供多位病患使用的產品。如需清潔、消毒和產品相容性資訊，請參閱《*IntelliVue MX40 使用說明*》。

加长线缆、适配器和主缆和心电电缆可重复使用于多名患者。关于清洁、消毒和产品适用性，请参见《*IntelliVue MX40 使用说明书*》。

For more information, please call your local Philips sales office listed in your telephone directory or a Philips regional office listed below for the location of your nearest sales office.

United States:
Philips Healthcare
North America Corporation
3000 Minuteman Road
Andover, MA 01810-1099
(800) 225-0230

Canada:
Philips Healthcare Canada
281 Hillmount Road
Markham, ON
L6C 2S3
(800) 291-6743

Latin America Headquarters:
Philips Healthcare Brazil
Rua Verbo Divino 1400 - 7° Andar
Chacara Santo Antonio
04719-002 Sao Paulo, SP
Brazil
Tel: +55 11 2125-0744
Fax: +55 11 2125-0761

EC REP

Europe, Middle East and Africa:
Philips Medizin Systeme
Böblingen GmbH
Hewlett-Packard Str. 2
71034 Böblingen, Germany
Tel: (+49) 7031 463 2254
Fax: (+49) 7031 463 1552

Asia Pacific Headquarters:
Philips Healthcare
30/F Hopewell Centre
17 Kennedy Road
Wanchai
Hong Kong
Tel: (852) 2821 5888
Fax: (852) 2527 6727

http://www.philips.com/healthcarestore

CE

Made in Germany

US Status:
Manufactured for Philips Medical Systems

Philips Healthcare
3000 Minuteman Road
Andover, MA 01810-1099
USA

GMDN 35562

Subject to modification

© 2011
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Printed in USA, June 2011

Part No. 453564230201

Stryker Internal Control No.: EL10050 Rev C

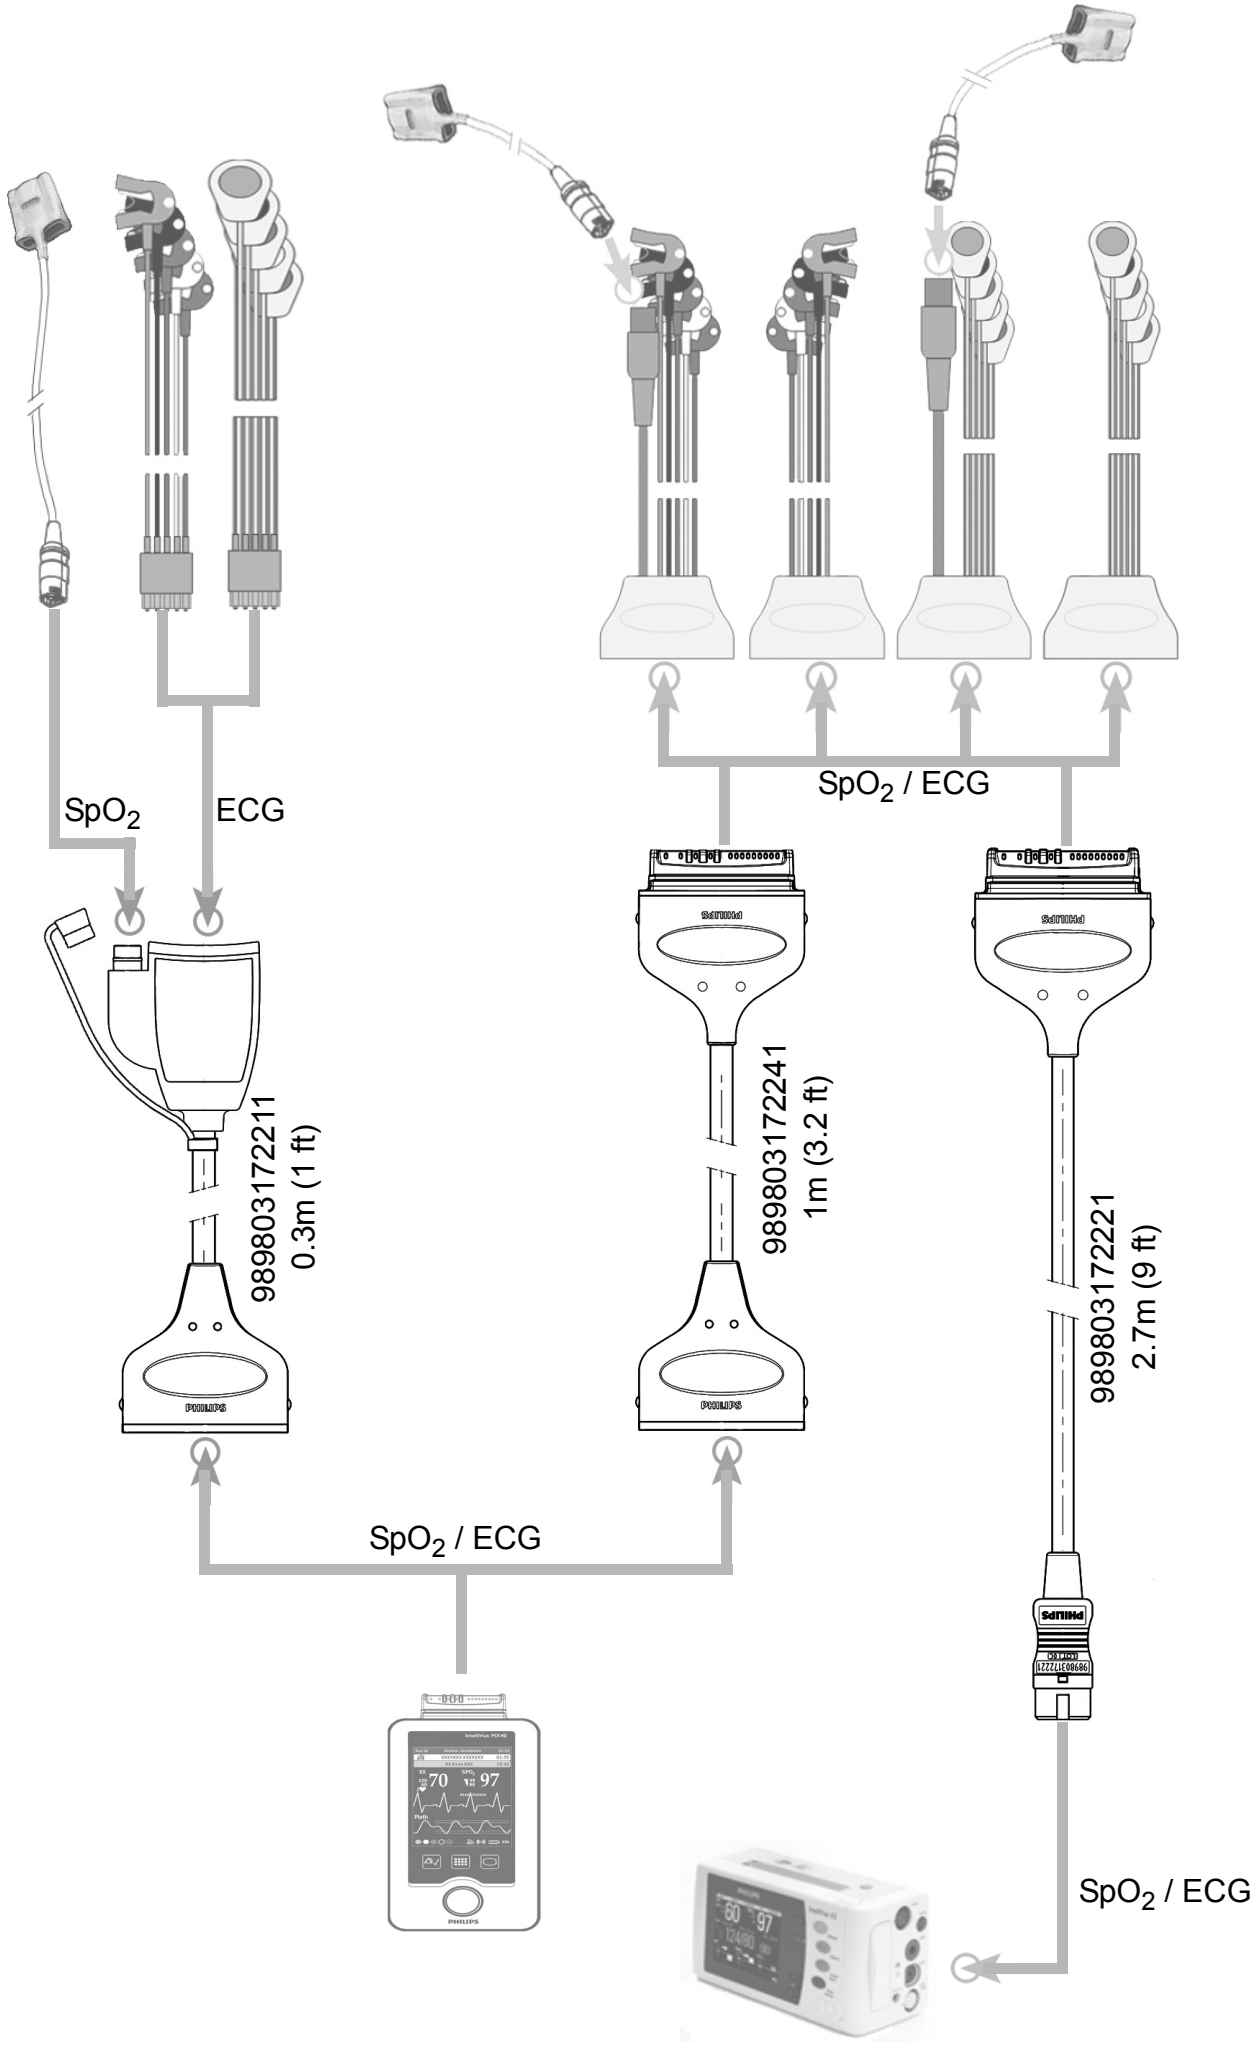
SpO2
ECG
SpO2 / ECG
989803172211
0.3m (1 ft)
989803172241
1m (3.2 ft)
989803172221
2.7m (9 ft)
SpO2 / ECG
SpO2 / ECG